

MICROMOTEUR MCX LED ET MCX



FR MODE D'EMPLOI.

Autres langues disponibles sur
<https://dental.bienair.com/IFU>

CE Rx Only
0123 REF 2100231-0008/2024.02

Contenu de l'emballage (REF)



MOT MCX LED
REF. 1600751-001



3X

O-RING 8.1x0.73
REF. 1300967-003



MOT MCX
REF. 1600780-001

Accessoires en option



HOSE MCX GREY
REF. 1600756-001



HOSE B-MCX GREY
REF. 1600824-001



10X

O-RING 8.1x0.73
REF. 1300967-010



FLOWMETER
REF. 1600307-001



HOSE MCX 400
REF. 1601081-001



HOSE MCX GREY 400° Ø20.2x40
REF. 1601096-001



HOSE MCX GREY 2.2m
REF. 1600920-001



HOSE MCX 400° gf.
REF. 1601141-001



6X

MAINT SPRAYNET* (BOÎTE DE 6 FLACONS)
REF. 1600036-006

Table des matières

1 Symboles	4	5.3 Désinfection	13
1.1 Description des symboles uti- lisés	4	5.4 Stérilisation	13
2 Identification et emploi prévu 5		5.4.1 Procédure	14
2.1 Identification	5	5.5 Lubrification	14
2.2 Emploi prévu	5	5.6 Emballage et stockage	15
2.3 Patientèle prévue	5	5.7 Révision	15
2.4 Utilisateur prévu	5	6 Transport et mise au rebut 16	
2.5 Environnement d'utilisation	5	6.1 Transport	16
2.6 Conditions mé- dicales prévues	5	6.2 Élimination	16
2.7 Contre-indications et effets secondaires pour le patient	5	7 Informations générales	17
2.8 En cas d'accident	5	7.1 Conditions de garantie	17
Sécurité de l'utilisateur et du		7.2 Références	17
3 patient : Avertissements et			
précautions d'utilisation	6		
3.1 Installation	7		
4 Description	8		
4.1 Aperçu	8		
4.2 Montage et préparation	9		
4.3 Caractéristiques techniques	10		
4.4 Classification	10		
4.5 Performances	10		
4.6 Conditions opérationnelles	10		
5 Entretien et services	11		
5.1 Entretien - Informations gé- nérales	11		
5.1.1 Produits d'entretien adéquats ..	11		
5.2 Nettoyage	12		

1 Symboles

1.1 Description des symboles utilisés

Symbole	Description	Symbole	Description
	Fabricant.		Référence catalogue.
	Marquage CE avec le numéro d'organisme notifié.		Numéro de série.
	AVERTISSEMENT : danger pouvant entraîner des blessures graves ou des dommages à l'appareil si les instructions de sécurité ne sont pas correctement respectées.		Dispositif médical.
	ATTENTION : danger pouvant entraîner des blessures légères ou modérées ou des dommages à l'appareil si les instructions de sécurité ne sont pas correctement respectées.		Représentant CE autorisé au sein de la communauté européenne.
	Portez des gants de protection.		Lampe, éclairage, lumière.
	Sécurité électrique. Partie appliquée, type B.		Peut être stérilisé dans un stérilisateur à vapeur (autoclave) à la température spécifiée.
Rx Only	Avertissement : selon la loi fédérale (États-Unis), cet appareil est disponible à la vente uniquement sur ordonnance d'un praticien agréé.		Consulter le mode d'emploi papier ou électronique.
	Code de matrice de données (QR code) pour les informations produit, y compris l'UDI (identifiant unique de l'appareil).		Limite de température.
	Limitation de l'humidité.		Limitation de la pression atmosphérique.
	Conserver à l'abri de la pluie.		Symbole général pour la récupération/le recyclage.
	Matériaux électriques et électroniques recyclables.		

2 Identification et emploi prévu

2.1 Identification

Dispositifs médicaux fabriqués par Bien-Air Dental SA.

Genre :

Micromoteur électrique sans balais, stérilisable, avec spray interne et lumière LED pour la référence 1600751-001.

Description :

Les micromoteurs Bien-Air Dental sont conçus pour transformer l'électricité en rotation mécanique pour entraîner les pièces à mains dentaires droites et les contre-angles.

2.2 Emploi prévu

Produit destiné à être utilisé en dentisterie générale, ce qui inclut la dentisterie restauratrice, la prophylaxie dentaire et les traitements orthodontiques.

2.3 Patientèle prévue

La patientèle prévue pour l'appareil comprend toute personne se rendant au cabinet d'un dentiste pour y recevoir des soins conformes aux indications médicales prévues. Il n'existe aucune restriction d'âge, de race ou de culture. Il incombe à l'utilisateur prévu de sélectionner l'appareil adéquat pour le patient en fonction de l'application clinique spécifique.

2.4 Utilisateur prévu

Produit réservé à un usage professionnel uniquement. Utilisé par les dentistes et les professionnels des soins dentaires.

2.5 Environnement d'utilisation

Environnement professionnel d'un établissement de soins.

2.6 Conditions médicales prévues

La médecine dentaire générale qui comprend la médecine dentaire restauratrice, la prophylaxie dentaire, l'orthodontie et vise le maintien ou le rétablissement de la santé dentaire.

2.7 Contre-indications et effets secondaires pour le patient

Il n'existe aucune contre-indication, aucun effet secondaire pour le patient, ni aucun avertissement pour l'appareil lorsqu'il est utilisé conformément à l'usage prévu.

2.8 En cas d'accident

Si un accident se produit, l'appareil ne doit plus être utilisé tant que les réparations n'ont pas été effectuées par un technicien qualifié et formé agréé dans un centre de réparation.

En cas d'accident grave en lien avec l'appareil, veuillez le signaler à une autorité compétente de votre pays, ainsi qu'au fabricant via votre distributeur régional. Reportez-vous aux réglementations nationales applicables pour connaître les procédures précises.



AVERTISSEMENT

Toute utilisation non conforme à l'emploi prévu de ce dispositif est interdite et peut s'avérer dangereuse.

3 Sécurité de l'utilisateur et du patient : Avertissements et précautions d'utilisation

AVERTISSEMENT

L'appareil doit être utilisé par des spécialistes des soins dentaires qualifiés, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur relatives aux mesures de protection en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents ainsi qu'au présent mode d'emploi. Conformément à ces exigences, les opérateurs :

- Doivent uniquement utiliser des appareils en parfait état de marche; en cas de fonctionnement anormal, de défaut de refroidissement, de vibrations excessives, de surchauffe, de bruit inhabituel ou d'autres signes pouvant indiquer un dysfonctionnement de l'appareil, le travail doit être immédiatement interrompu; dans ce cas, contacter un centre de réparation approuvé par Bien-Air Dental SA et demander au personnel du service d'effectuer les réparations;
- Doivent s'assurer que l'appareil est utilisé exclusivement pour l'usage auquel il est destiné, doivent se protéger eux-mêmes, leurs patients et les tiers de tout danger.
- Il est strictement interdit de modifier le dispositif médical.

Sécurité électrique :

AVERTISSEMENT

La sécurité électrique ne peut être revendiquée que lorsque l'appareil est utilisé avec des moteurs d'entraînement et des tuyaux compatibles Bien-Air Dental.

- Toujours se référer au mode d'emploi de l'unité dentaire ou de la console pour confirmer la compatibilité avec l'appareil et la conformité en matière de sécurité électrique.
- Lorsqu'il est utilisé avec des dispositifs

médicaux Bien-Air Dental, l'appareil est conforme à la norme CEI 60601-1, pour laquelle les exigences suivantes s'appliquent :

- Protection contre les chocs électriques
- Intrusion de liquides
- Protection contre les températures excessives et autres dangers

Compatibilité électromagnétique :

AVERTISSEMENT

- La compatibilité électromagnétique ne peut être revendiquée que lorsque l'appareil est utilisé avec des moteurs d'entraînement et des tuyaux compatibles Bien-Air Dental.
- Toujours se référer au mode d'emploi de l'unité dentaire ou de la console pour confirmer la compatibilité avec l'appareil et la conformité électromagnétique.
- La conformité à la norme internationale CEI 60601-1-2 ne garantissant pas l'immunité contre la 5G dans le monde entier (en raison des différentes bandes de fréquences utilisées localement), il convient d'éviter la présence d'appareils équipés de réseaux cellulaires à large bande 5G dans l'environnement clinique ou de s'assurer que la fonctionnalité réseau de ces appareils est désactivée pendant la procédure clinique.
- Des perturbations magnétiques peuvent être provoquées par d'autres dispositifs médicaux électroniques. Se référer au mode d'emploi de l'unité dentaire ou de la console pour consulter les spécifications CEM.

Veillez respecter l'avertissement suivant pour éviter tout risque d'explosion :

AVERTISSEMENT

Conformément à la norme CEI 60601-1:2005 +A1 2012 / Annexe G, les dispositifs électrifiés (moteurs, modules de contrôle, coupleurs et accessoires) peuvent uniquement être utilisés en toute sécurité dans un environnement médical dans lequel des mélanges potentiellement explosifs ou inflammables de substances anesthésiantes sont administrées au patient si :

- La distance entre le moteur et le circuit respiratoire pour l'anesthésie est supérieure à

25 cm.

- Le moteur n'est pas utilisé durant l'administration des substances anesthésiantes au patient.

Prière de respecter les avertissements suivants pour éviter tout risque d'infection :

⚠ AVERTISSEMENT

- L'appareil est livré non stérile. Veuillez respecter la procédure de nettoyage, stérilisation et maintenance décrite à la section 5 pour éviter toute infection.
- Les précautions universelles, notamment le port de l'équipement de protection individuelle (gants, lunettes, etc.), doivent être observées par le personnel médical qui utilise ou entretient des dispositifs médicaux contaminés ou potentiellement contaminés. Les instruments pointus ou tranchants doivent être manipulés avec une grande prudence.
- Poser l'appareil sur un support lavable.

Veillez respecter les mises en garde suivantes pour éviter tout risque de surchauffe du moteur :

⚠ ATTENTION

- Le moteur doit être connecté au système de refroidissement de l'unité dentaire pour éviter une surchauffe et/ou une limitation automatique de la vitesse par le contrôle de sécurité du circuit électronique.
- Toujours s'assurer que le tuyau du micromoteur n'est pas plié et que le tuyau ainsi que le moteur sont en bon état.

Veillez respecter les mises en garde suivantes pour éviter tout risque de blessure et/ou de dommages matériels :

⚠ ATTENTION

- En cas de vibrations excessives, d'échauffement anormal, de bruit inhabituel ou d'autres signes laissant présager un dysfonctionnement du dispositif, le travail doit être immédiatement interrompu. Dans ce cas, s'adresser à un centre de réparation

agréé par Bien-Air Dental SA.

- Ne jamais brancher d'instrument sur un micromoteur en fonctionnement.
- Ne pas pulvériser de lubrifiant ou de solution de nettoyage dans le moteur.
- Ne jamais rincer l'appareil pour le refroidir.
- Il est indispensable d'utiliser de l'air comprimé sec et purifié dans l'unité dentaire afin de garantir la longévité de l'appareil. Maintenir la qualité de l'air et de l'eau par un entretien régulier du compresseur et des systèmes de filtration. L'utilisation d'eau dure non filtrée entraînera une obstruction précoce des tubes et des connecteurs.

3.1 Installation

⚠ AVERTISSEMENT

Le micromoteur ne doit être utilisé qu'avec des appareils électroniques Bien-Air Dental ou compatibles. Pour respecter les exigences de sécurité de la norme CEI 60601-1, il faut utiliser exclusivement une alimentation pour dispositif médical avec deux MOPP.



FIG. 1

4 Description

4.1 Aperçu

FIG. 1

- (1) Nez du moteur
- (2) Corps du moteur
- (3) Branchement tuyau/moteur

Nota : Les spécifications techniques, illustrations et cotes contenues dans les présentes instructions ne sont données qu'à titre indicatif. Elles ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.

La version originale de ce mode d'emploi est en anglais.

Pour tout complément d'information, prière de contacter Bien-Air Dental SA à l'adresse inscrite au dos.

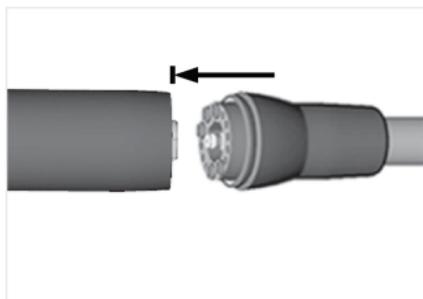


FIG. 2

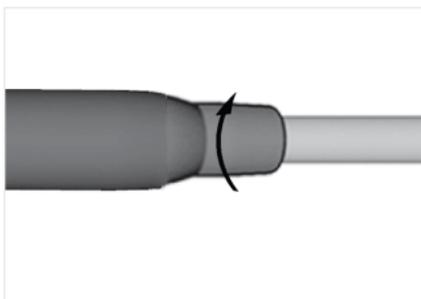


FIG. 3

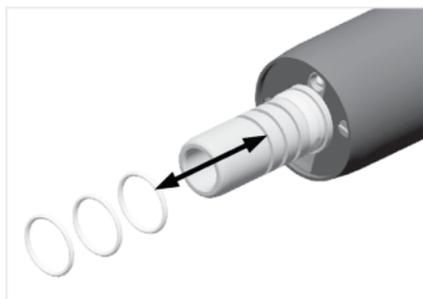


FIG. 4



FIG. 5

4.2 Montage et préparation

1. Vérifier que l'arrière du moteur et le connecteur du tuyau sont propres et secs.
2. Raccorder le moteur au tuyau exclusif (avec le connecteur de type MCX) comme indiqué sur la FIG. 2.
3. Tourner celui-ci afin de trouver la position exacte et l'enfoncer dans le moteur.
4. En maintenant le moteur, visser complètement le manchon du tuyau sur le connecteur arrière du moteur FIG. 3.
5. Placer le débitmètre sur l'embout nasal, activer l'air de refroidissement, puis mesurer le débit d'air. La valeur se mesure au milieu de la bille du débitmètre selon la norme JIS B7551. FIG. 5.
6. Si le débit d'air de refroidissement n'est pas de 10 NL/min. (+/- 10 %), régler la pression d'air pour respecter cette exigence.

Remplacer les joints à la main (aucun outil requis) FIG. 4

- Ne pas lubrifier le joint torique.
- Utiliser uniquement des joints toriques exclusifs.
- Vérifier que les joints toriques ne sont ni cassés ni rayés après les avoir posés.

4.3 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Flux d'air recommandé (mesuré au nez du moteur)	10 NU/min (+/-10 %)
Plage de pression atmosphérique	2,5 -5 bars
Accouplement	Nez conforme à la norme ISO 3964*
Durées de fonctionnement	Pas de limite pour l'utilisateur. Les durées de fonctionnement sont imposées électroniquement par les panneaux de contrôle Bien-Air, en fonction du couple appliqué.
Plage des vitesses de rotation	100 – 40 000 tr/min
Sens de rotation	Dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse
Intensité lumineuse	LED, variable de 20 klux à 24 klux**

*Compatible avec des pièces à main « courtes », « intermédiaires » et « longues ».

**Mesurée avec le CA 1: 5L NOVA MS REF1601138-001

4.4 Classification

Classe IIa en conformité avec la réglementation européenne (EU) 2017/745 relative aux dispositifs médicaux. Dispositif de classe II type B en conformité avec la norme CEI 60601-1.

4.5 Performances

Performances	
Indiquer la vitesse et le couple pré-réglés	Contrôlée électroniquement
Précision de la valeur pour la vitesse	+/- 5 %

4.6 Conditions opérationnelles

Conditions opérationnelles	
	Plage de température : +10 °C – +35 °C (+50 °F – +95 °F)
	Plage d'humidité relative : 30 % – 80 %
	Plage de pression atmosphérique : 700 hPa – 1 060 hPa



FIG. 6

5 Entretien et services

5.1 Entretien - Informations générales

Nettoyer et stériliser l'appareil avant la première utilisation.

Dans un délai maximum de 30 minutes après chaque traitement, nettoyer le moteur. Respecter cette procédure permet d'éliminer tout résidu de sang ou de salive.

AVERTISSEMENT

Suivre les directives, normes et règles nationales pour les recommandations de nettoyage et de stérilisation.

ATTENTION

Ne pas pulvériser de lubrifiant ou de solution de nettoyage dans le moteur. [FIG. 6.](#)

5.1.1 Produits d'entretien adéquats

Utiliser uniquement des produits d'entretien et des pièces Bien-Air Dental SA d'origine ou recommandés par Bien-Air Dental SA. L'utilisation d'autres produits ou pièces peut engendrer des défauts de fonctionnement et/ou une annulation de la garantie.

- Spraynet®
- Détergent ou détergent-désinfectant alcalin (pH 8 à 11) recommandé pour le nettoyage et la désinfection des instruments dentaires ou chirurgicaux. Les produits désinfectants à base de chlorure de didécyltriméthylammonium, de carbonate d'ammonium quaternaire ou d'un produit enzymatique neutre (par exemple, neodisher® Mediclean) sont également autorisés.

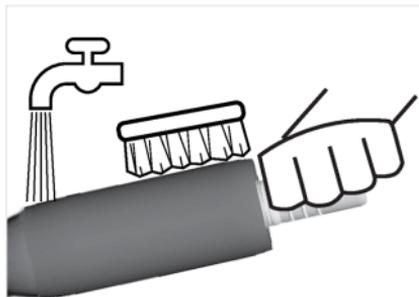


FIG. 7

5.2 Nettoyage

⚠ ATTENTION

- Ne pas immerger l'appareil dans un liquide physiologique (NaCl) et ne pas utiliser de solution saline pour le garder humide jusqu'à ce qu'il puisse être nettoyé.
- Ne pas immerger dans un bain de nettoyage.
- Ne pas utiliser dans un laveur-désinfecteur ni un bain à ultrasons.
- Ne pas pulvériser de solution de nettoyage dans le moteur.
- Toujours s'assurer que les contacts du moteur restent propres.

La surface extérieure du moteur doit être nettoyée comme suit pour éliminer les impuretés **FIG. 7**

- En tenant le moteur par le nez, le maintenir sous l'eau du robinet à une température entre 15 °C et 38 °C (59 °F et 100 °F), à condition que l'eau du réseau de distribution locale ait un pH compris entre 6,5 et 8,5 et une teneur en chlorure inférieure à 100 mg/l. Si l'eau du réseau de distribution local ne répond pas à ces exigences, utiliser de l'eau déminéralisée (désionisée) à la place.
- À l'aide d'une brosse souple et lisse, nettoyer la surface extérieure du câble avec les produits de nettoyage préconisés.
- Ne pas laisser d'eau s'infiltrer dans le moteur que ce soit par le nez ou le raccord du tuyau.
- Sécher la surface extérieure du câble avec un chiffon peu pelucheux humidifié avec Spraynet®.

5.3 Désinfection

Frotter soigneusement les surfaces extérieures du moteur pendant environ une minute avec une brosse souple et lisse, imprégnée d'une solution détergente ou désinfectante **FIG. 7**.

Le moteur doit être rincé comme suit **FIG. 6**

- En tenant le moteur par le nez, le maintenir sous l'eau du robinet à une température entre 15 °C et 38 °C (59 °F et 100 °F), comme illustré dans le diagramme ci-dessous, à condition que l'eau du réseau de distribution locale ait un pH compris entre 6,5 et 8,5 et une teneur en chlorure inférieure à 100 mg/l. Si l'eau du réseau de distribution local ne répond pas à ces exigences, utiliser de l'eau déminéralisée (désionisée) à la place.
- Ne pas laisser d'eau s'infiltrer dans le moteur, que ce soit par le nez ou le raccord du tuyau.

- Sécher le moteur à l'aide d'une compresse non tissée.

5.4 Stérilisation

ATTENTION

- La qualité de la stérilisation dépend très fortement de la propreté du dispositif. Ne stériliser que des instruments parfaitement propres.
- Pour améliorer l'efficacité de la stérilisation, s'assurer que le moteur est parfaitement sec.
- Ne pas appliquer de procédure de stérilisation autre que celle décrite ci-dessous.
- Utiliser uniquement des cycles d'extraction dynamique de l'air : cycles prévides ou à élimination de vapeur par pression pulsée (SFPP).
- Si la stérilisation est requise par des directives nationales, n'utiliser que des stérilisateurs à extraction dynamique : ne pas utiliser de stérilisateur à vapeur avec un système de déplacement par gravité. Comme pour tous les instruments, après chaque cycle de stérilisation, y compris le séchage, retirer l'appareil pour éviter une exposition excessive à la chaleur susceptible d'entraîner de la corrosion.

5.4.1 Procédure

1. Emballer l'appareil dans un emballage approuvé pour la stérilisation à la vapeur.
2. Stériliser à la vapeur en observant un cycle d'extraction dynamique de l'air (ANSI/AAMI ST79, Section 2.19), c.-à-d. en éliminant l'air via un système d'évacuation forcée (ISO 17665-1, ISO/TS 17665-2) à 135 °C (275 °F) pendant 3 minutes ou à 132 °C (269,6 °F) pendant 4 minutes. Dans les régions exigeant une stérilisation contre les prions, stériliser à 135 °C (275 °F) pendant 18 minutes.

L'instrument supporte plus de 1 000 stérilisations.

Les paramètres recommandés pour le cycle de stérilisation sont les suivants :

- La température maximale dans la chambre de l'autoclave ne dépasse pas 137 °C (278,6 °F). La température nominale de l'autoclave doit donc être réglée sur 134 °C (273,2 °F), 135 °C (275 °F) ou 135,5 °C (275 °F) en tenant compte de l'incertitude associée à la température du stérilisateur.
- La durée maximale de l'intervalle à la température maximale de 137 °C (278,6 °F) est conforme aux exigences nationales pour la stérilisation par vapeur humide et ne dépasse pas 30 minutes.
- La pression absolue dans la chambre du stérilisateur est comprise entre 0,07 bar et 3,17 bars (1 psia et 46 psia).
- La vitesse de changement de température ne dépasse pas 15 °C/min (59 °F/min) en température ascendante et -35 °C/min (-31 °F/min) en température descendante.
- La vitesse de changement de pression ne dépasse pas 0,45 bar/min (6,6 psia/min) en pression ascendante et -1,7 bar/min (-25 psia/min) en pression descendante.
- Aucun réactif chimique ou physique n'est ajouté à la vapeur d'eau.

5.5 Lubrification



Ne pas pulvériser de lubrifiant ou de solution de nettoyage dans le moteur **FIG. 8**.

5.6 Emballage et stockage

Conditions de stockage

	Plage de température :	0 °C – +40 °C (+32 °F – +104 °F)
	Plage d'humidité relative :	10 % – 80 %
	Plage de pression atmosphérique :	650 hPa - 1 060 hPa
	Conserver à l'abri de la pluie	

L'appareil doit être stocké dans la pochette de stérilisation dans un environnement sec et sans poussière. La température ne doit pas dépasser 55 °C (131 °F). S'il n'est pas prévu que l'appareil soit utilisé pendant au moins 7 jours après la stérilisation, enlever l'appareil de la pochette de stérilisation et le conserver dans l'emballage d'origine. Si l'appareil n'est pas stocké dans une pochette de stérilisation ou si la pochette n'est plus stérile, nettoyer, sécher et stériliser l'appareil avant de l'utiliser.

ATTENTION

Si l'appareil médical a été conservé au réfrigérateur, le laisser se réchauffer à température ambiante avant utilisation.

ATTENTION

Respecter la date d'expiration de la pochette de stérilisation qui dépend des conditions de stockage et du type d'emballage.

5.7 Révision

Bien-Air Dental SA recommande à l'utilisateur de vérifier et d'assurer la maintenance de ses appareils dynamiques après 5 000 cycles de fonctionnement ou 5 ans.

ATTENTION

Ne démontez jamais l'appareil. Pour toute modification ou réparation, contacter votre fournisseur habituel ou le centre de services Bien-Air Dental.

6 Transport et mise au rebut

6.1 Transport

Conditions de transport



Plage de température :

-20 °C – +50 °C (-4 °F – +122 °F)



Plage d'humidité relative :

5 % – 80 %



Plage de pression atmosphérique :

650 hPa – 1 060 hPa



Conserver à l'abri de la pluie

6.2 Élimination



La mise au rebut et/ou le recyclage de matériaux doivent se faire conformément à la législation en vigueur.



Cet appareil doit être recyclé. Les dispositifs électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement. L'utilisateur doit renvoyer l'appareil à son revendeur ou s'adresser directement à un organisme agréé de traitement et de récupération de ce type d'équipement (Directive européenne 2012/19/UE).

7 Informations générales

7.1 Conditions de garantie

Bien-Air Dental SA octroie à l'opérateur une garantie couvrant tous les dysfonctionnements, défauts matériels et défauts de production.

La durée de la garantie est de :

- 36 mois à compter de la date de facturation.

En cas de réclamations fondées, Bien-Air Dental ou son représentant autorisé effectue la remise en état ou le remplacement gratuit du produit, remplissant ainsi les obligations de l'entreprise au titre de cette garantie.

Toute autre réclamation, de quelque nature que ce soit, notamment les réclamations pour dommages ou blessures et leurs conséquences résultant :

- d'une usure excessive ;
- d'une utilisation peu fréquente ou incorrecte ;
- de la non-observation des instructions de service, de montage et d'entretien ;
- d'influences chimiques, électriques ou électrolytiques inhabituelles ;
- de mauvais branchements, que ce soit en air, eau ou électricité.

ATTENTION

La garantie devient caduque lorsque les dommages et leurs suites résultent d'interventions inadaptées ou de modifications du produit effectuées par des tiers non autorisés par Bien-Air Dental. Les demandes de garantie ne seront prises en considération que sur présentation, avec le produit, d'une copie de la facture ou du bordereau de livraison. Les informations suivantes doivent être clairement indiquées : date d'achat, référence du produit et numéro de série.

7.2 Références

RÉF.	Légende
1600680-001	MC3 LED micromotor with internal spray and light with LED
1600077-001	MC3 LK micromotor with internal spray and light with bulb
1600071-001	MC3 IR micromotor with internal spray, without light
1600097-001	HOSE 4VLM11 GREY
1600102-001	HOSE 4VLM GREY
1600397-001	HOSE 4VR400 GREY
1300967-010	O-ring 8.1x0.73
1300148-001	SLEEVE Compatible with MOT MC3 LK & MOT MC3 IR COVER MC3 LK LED
1304416-001	SLEEVE Compatible with MOT MC3 (LED)
1500007-005	Pack of 5 bulbs, for micromotors
1600307-001	Flowmeter, for micromotors
1600036-006	Spraynet®, cleaning spray 500 ml, box of 6 cans



Bien-Air Dental SA

Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland

Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91

dental@bienair.com

Other addresses available at

www.bienair.com

EC REP Bien-Air Europe Sàrl

19-21 rue du 8 mai 1945

94110 Arcueil

France